

MANUEL SİSTEM

REFERANS KODU	ÜRÜN ADI	AMBALAJ ŞEKLİ
TG401	TEST-IT Gel Centrifuge	1X1
TG402	TEST-IT Gel Incubator	1X1
TG403	TEST-IT Gel Reader	1X1
TG404	TEST-IT Gel Pipette	1X1
TG405	TEST-IT Gel Dispencer	1X1
TG406	TEST-IT Gel Workstation	1X1
TG407	TEST-IT Gel Pipette Tip	500 ad/paket
TG408	TEST-IT Gel Test Tube	500 ad/paket



TEST-IT GEL WORK STATION
Jel kartları ve tüpler için çalışma istasyonu.



TEST-IT CENTRIFUGE
Jel kart santrifüjü, 24 kart kapasiteli



TEST-IT INCUBATOR
Jel kart inkubatörü, 24 kart kapasiteli.



TEST-IT PIPETTE
Tekrarlı pipet, 10µl, 25µl, 50µl

TAM TESPİT VE GÜVENLİ TRANSFÜZYON

Transfüzyon Tıbbı, kan transfüzyonunda en yüksek güvenlik düzeyini sağlamaktan sorumludur. Kan nakli hayat kurtaran bir müdahale olabilir.

Transfüzyon öncesi testlerinin amacı, alıcıya zarar vermeyecek ve transfüzyon sırasında kabul edilebilir bir yaşam süresine sahip olacak kan bileşenlerini seçmektir.

Düzenli bir şekilde gerçekleştirilirse, ön transfüzyon testleri kan bileşeni ve alıcı arasındaki ABO uyumluluğunu doğrulayacak ve klinik olarak önemli beklenmedik antikorların çoğunu tespit edecektir.

TEST-IT Jel kartları, kan gruplaması için kolon aglütinasyon tekniğini temel alır ve beklenmedik antikorları tanımlar. Transfüzyon öncesi uyumluluk testlerini yapmak için kullanılan TEST-IT GEL kartları ve reaktifleri, hastalara zamanında ve güvenli transfüzyon sağlar.

TEST-IT Jel kartları, güvenli transfüzyon için uygun maliyetli ve kullanıcı dostu ürünlerden oluşan eksiksiz bir profil sunar.

AVANTAJLAR




JEL KART TEKNOLOJİSİ



8 MİKROTÜP



TAM PROFİL



%100 KART KULLANIMI



STABİL SONUÇLAR



MAKSİMUM BİLGİ



ESNEKLİK VE UYUMLULUK




OTOMASYON




KAN GRUPLAMA
ÜRÜN BROŞÜRÜ


JEL KARTLARI

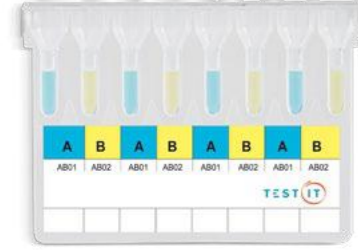


TEST-IT Gel
AB (x4)
REF TG101

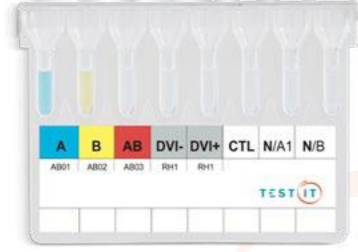


TEST-IT Gel
ABO/2D & Reverse
REF TG102

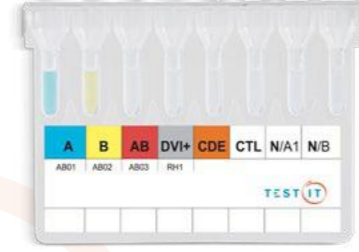


TEST-IT Gel
ABO/CDE (DVI+) & Reverse
REF TG103

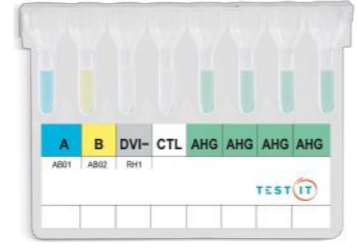


TEST-IT Gel
Type / Screen
REF TG113

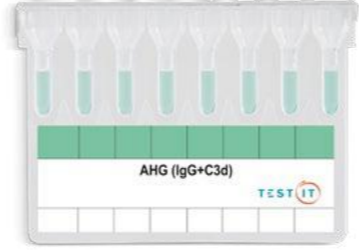


TEST-IT Gel
Coombs
REF TG114

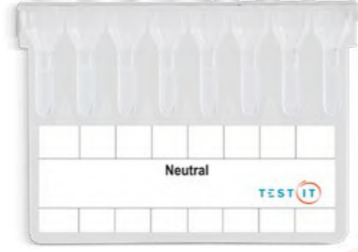


TEST-IT Gel
Neutral
REF TG115

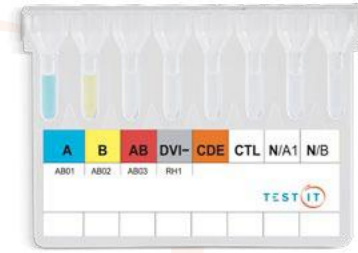


TEST-IT Gel
ABO/CDE (DVI-) & Reverse
REF TG104

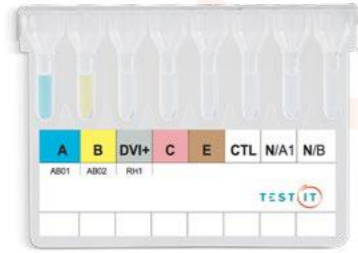


TEST-IT Gel
ABO/Rh(C,E) DVI+ & Reverse
REF TG105

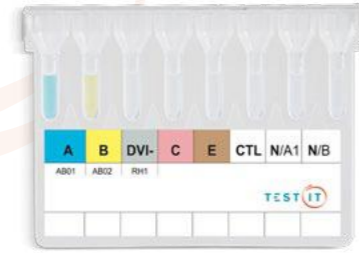


TEST-IT Gel
ABO/Rh(C,E) DVI- & Reverse
REF TG106

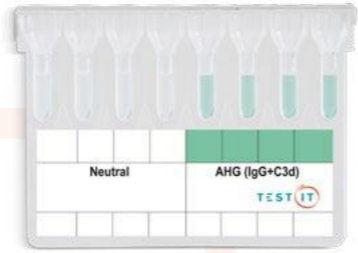


TEST-IT Gel
Neutral / Coombs
REF TG116

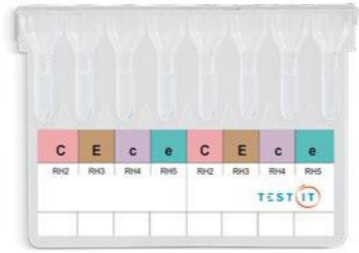


TEST-IT Gel
Rh Phenotype
REF TG117

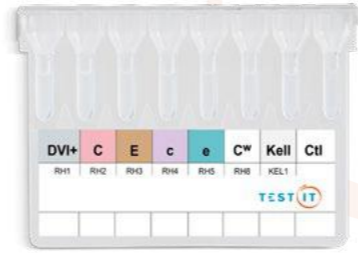


TEST-IT Gel
Rh Phenotype + Kell
REF TG118

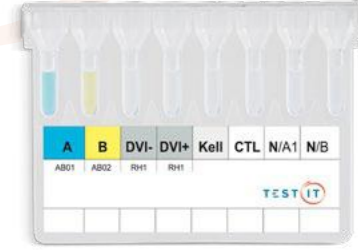


TEST-IT Gel
ABO/2D + Kell & Reverse
REF TG107

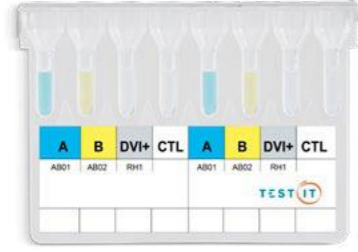


TEST-IT Gel
Confirm ABO/DVI+
REF TG108

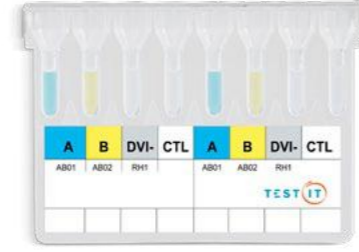


TEST-IT Gel
Confirm ABO/DVI-
REF TG109

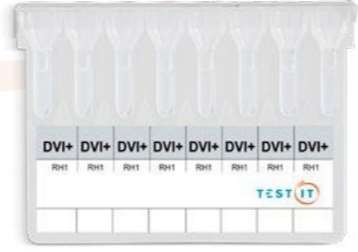


TEST-IT Gel
Gel Anti-DVI+
REF TG119

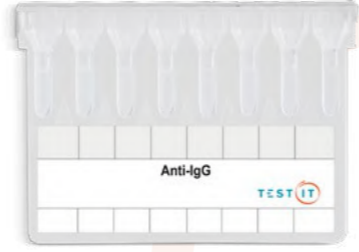


TEST-IT Gel
Gel Anti-IgG
REF TG120

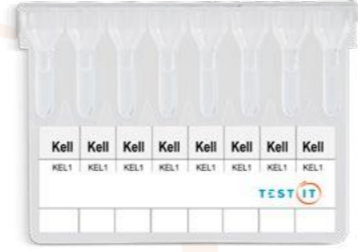


TEST-IT Gel
Anti-Kell
REF TG121

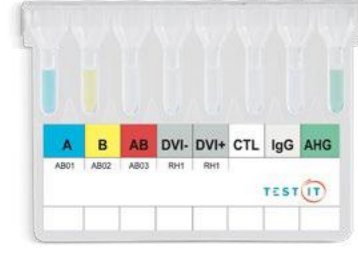


TEST-IT Gel
Newborn
REF TG110

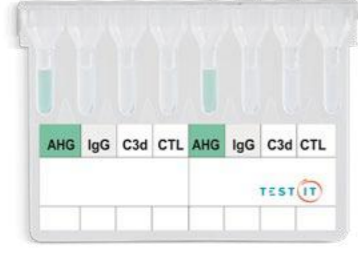

TEST-IT Gel
DAT Screen
REF TG111

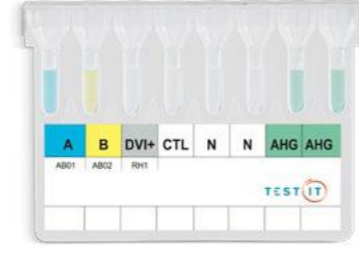

TEST-IT Gel
Cross Match
REF TG112

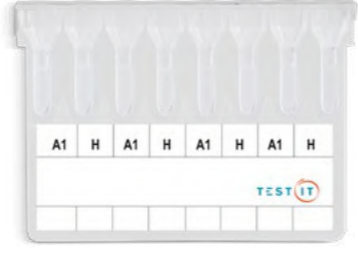

TEST-IT Gel
ABO Type
REF TG122

DİLÜENT VE SOLÜSYONLAR

REFERANS KODU	ÜRÜN MİADİ	ÜRÜN ADI	AMBALAJ ŞEKLİ
TG301	2 Yıl	TEST-IT LISS	100 ml
TG302	2 Yıl	TEST-IT LISS	500 ml
TG303	9 Ay	TEST-IT Bromelin	30 ml
TG304	9 Ay	TEST-IT Bromelin	100 ml
TG305	6 Ay	TEST-IT Papain	10 ml



TEST-IT
PAPAIN



TEST-IT
BROMELIN



TEST-IT
LISS

Enzim deneyleri yapmak için sıvı papain ve bromelin çözeltileri.

Kırmızı kan hücreleri süspansiyonlarını hazırlamak için kullanılan solüsyon.

KIRMIZI KAN HÜCRESİ REAKTİFLERİ 0.8%

REFERANS KODU	ÜRÜN MİADİ	ÜRÜN ADI	AMBALAJ ŞEKLİ
TG201	6 Hafta	TEST-IT Cell A1-A2-B-O	4 x 10 ml
TG202	6 Hafta	TEST-IT Cell Reverse A1-B	2 x 10 ml
TG203	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 2	2 x 10ml
TG204	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 3	3 x 10 ml
TG205	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 4	4 x 10 ml
TG206	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 2P	2 x 10 ml
TG207	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 3P	3 x 10 ml
TG208	6 Hafta	TEST-IT Cell Screen 4P	4 x 10 ml
TG209	6 Hafta	TEST-IT Cell Panel 11	11 x 5 ml
TG210	6 Hafta	TEST-IT Cell Panel 11 P	11 x 5 ml
TG211	6 Hafta	TEST-IT Cell Coombs Control	1 x 10 ml
TG212	6 Hafta	TEST-IT Cell Quality Control - 2	2 x 6 ml
TG213	6 Hafta	TEST-IT Cell Quality Control - 4	4 x 6 ml



TEST IT CELL
A1



TEST IT CELL
B